

一般社団法人 日本超音波骨軟組織学会

---

# ロゴマーク マニュアル



## ロゴの基本形

### 横型



### 縦型



## 色規程



**JSBMブルー**  
DIC2178  
C59, M16, Y5, K0



**JSBMレッド**  
PANTONE 186C  
C0, M100, Y90, K0



**スミ**  
K100

## 書体



A-OTF 新ゴPro M

一般社団法人  
日本超音波骨軟組織学会

## カラー設定

	CMYKモード	RGBモード
	DIC 2178 (濃度95%) / C59, M16, Y5, K0	R 90, G181, B226
	DIC 2178 (濃度85%) / C53, M15, Y5, K0	R107, G189, B227
	DIC 2178 (濃度70%) / C50, M14, Y4, K0	R132, G201, B232
	DIC 2178 (濃度60%) / C37, M11, Y3, K0	R148, G208, B236
	PANTONE 186C / C0, M100, Y90, K0	R207, G21, B45
	BK43	
	BK40	
	BK37	
	BK35	

※指定外 K100 (R0, G0, B0)

## 背景とのカラーバランス




背景の色濃度は10%以下



ロゴを白抜きベースで使用する場合、上記の例を参考に使用する。

## 余白設定

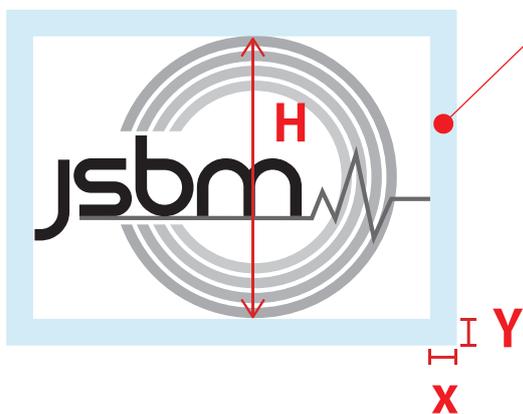


他の要素に埋もれないように  
X,Y共にHの1/10以上のスペースを設ける




# 使用例

## ●封筒

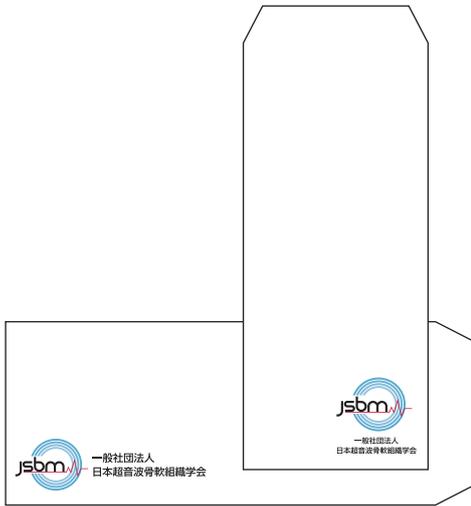

長型

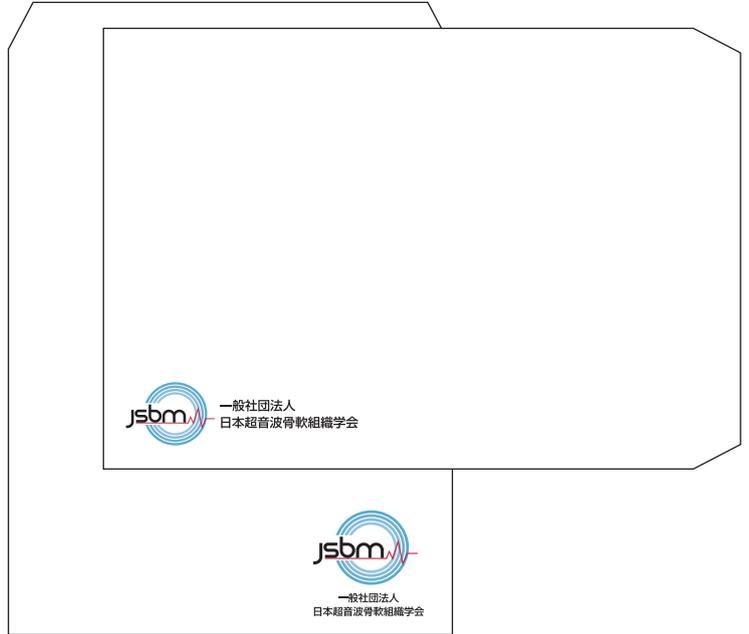

角型

## ●広告(四隅いずれかに配置)



## 英語表記


書体: Adobe Caslon Pro-Regular



## 使用禁止例




色を変えてはいけない

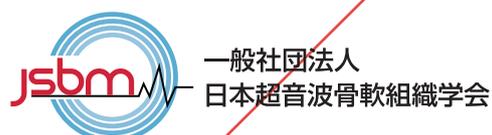

色の組み合わせを変えてはいけない




ロゴマークとロゴタイプの組み合わせを変えてはいけない

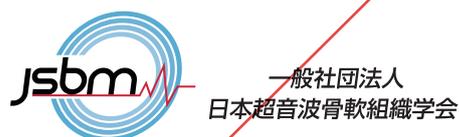

変形させてはいけない



組み合わせの比率や配置を変えてはならない

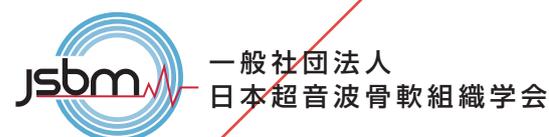

字間を広げたり狭めてはいけない