

訂正：「入門 運動器の超音波観察法 実技編 ～プローブ走査を中心に～」2019年5月13日
日本超音波骨軟組織学会 編（医歯薬出版株式会社）

【訂正内容】

①51 ページ 図 2

橈側と尺側の表示が逆に表記

（誤）

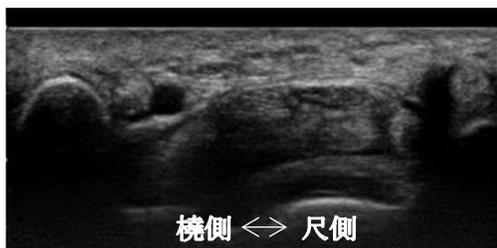


図 2 エコー画像でのランドマーク(手根管近位列短軸像)とシェーマ



（正）

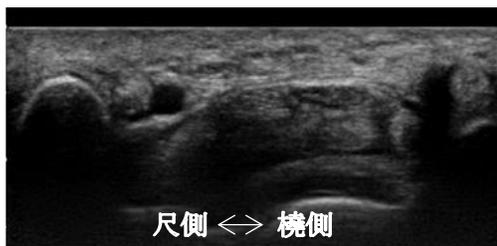


図 2 エコー画像でのランドマーク(手根管近位列短軸像)とシェーマ

②56 ページ 図 16

白線の①と②が逆に表記

（誤）

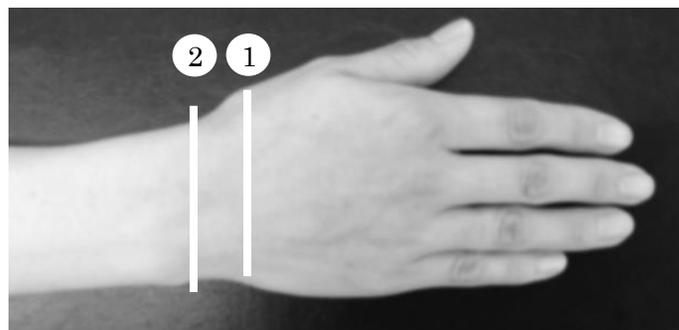


図 16 手関節背側 短軸 プローブ位置とシェーマ



(正)

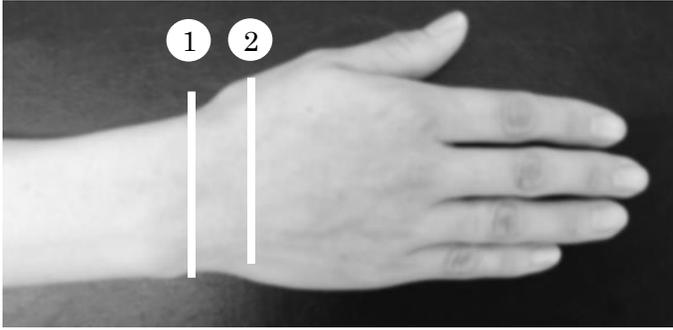


図 16 手関節背側 短軸 プローブ位置とシェーマ